



Miljøministeriet
Miljøstyrelsen

Datateknisk anvisning Marin Vandkemi og Feltmålinger

Oktober 2023

dTA-Titel: Marin Vandkemi og Feltnålinger			
Dokumenttype: Datateknisk anvisning	TA. nr.: DM01	Version: 1.0	Oprettet: 16.03.2023 af MST
Ansvarlig fagkoordinationsgruppe i MST: FKG Marin	Sidst ændret og gyldig fra: 04.10.2023		
Forfattere: Benny Bruhn (MST)	Sider: 26		
Relaterede tekniske anvisninger (TA'er): M01 Indsamling af vand- og planktonprøver i felten, M02 Vandkemi M03 CTD måling M04 Ilt i vandsøjlen M05 Fluorescens M06 Lyssvækkelse M07 Klorofyl a koncentration	Relaterede dTA'er: DM01 – Marin vandkemi og feltnålinger (historisk, Det marine fagdatacenter)		
	Relateret KS-metodebeskrivelse: Beskrivelse af metoder til faglig kvalitetssikring af dataemner i NOVANA-rapportering for marine områder.		

Udgiver: Miljøstyrelsen

Redaktion: Miljøstyrelsen

Indhold

1.	Indledning og afgrænsning	4
1.1	Brugere	4
2.	Dataflow og niveauer i kvalitetssikringsprocessen	5
3.	Indtastning/overførsel af data til inputsystem	7
3.1	Indtastning af data og oprettelse af rekvisition	7
3.1.1	Bemærkningsfelter	8
3.2	Kontrol med manglende data	9
3.3	Opbevaring af rådata	9
3.4	Oprettelse af stationer/lokaliteter	9
3.5	Koder og dataudvekslingsformat	9
4.	Kvalitetssikring	11
4.1	Kvalitetssikringsflow	11
4.1.1	Kvalitetsmærker og forbehold i VanDa	11
4.1.2	Redigering af undersøgelser	14
4.1.3	Genafreporterede analyseresultater	14
4.1.4	Laboratorieanalyser rekvireret fra laboratorie	14
4.1.5	Overførsel af data fra VanDa til KS2 Databank	14
4.2	Indtastnings- og indlæsningskontrol samt valideringer i WinArop – Marin og VanDa (KS1)	14
4.3	Kvalitetssikring i KS2 Databank – Analysekvalitetskontrol og KS2-regler	15
4.3.1	Analysekvalitetskontrol	15
4.3.2	KS2-regler og automatisk godkendelse	15
4.3.3	Manuel håndtering af data i KS2 Databank	15
	Bilag 1. Anvendte begreber	20
	Bilag 2. Kodelister	22
	Bilag 3. Detaljeret kvalitetssikringsflow	23
	Bilag 4. Oversigt over versionsændringer	26

1. Indledning og afgrænsning

Denne datatekniske anvisning (dTA) beskriver kravene til og den konkrete fremgangsmåde for Miljøstyrelsens (MST's) behandling af data fra overvågningen af marin Vandkemi og Feltnmålinger i regi af det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur (NOVANA).

Databehandling omfatter i dTA'ens forstand både indtastning og overførsel af data til støtte- eller fagsystemer, korrektioner og beregninger, samt kvalitetskontrol af data på forskellige niveauer på datas vej fra felt til fagsystem.

En række af de øvrige begreber, som anvendes i teksten, er defineret i Bilag 1.


1.1 Brugere

De primære brugere af dTA'en er personer, som skal behandle data fra MST's overvågning af marin Vandkemi og Feltnmålinger.

2. Dataflow og niveauer i kvalitetssikringsprocessen


Det generelle dataflow for MST's behandling af data fra overvågningen af marin Vandkemi og Feltmålinger er vist i nedenstående Figur 1, 2 og 3. Dataflowet starter, når undersøgelsen oprettes i inputsystemet, og slutter, når de autoritative, kvalitetssikrede og deklarerede¹ data ligger i VanDa. Flowet i Figur 1, 2 og 3 er forsimplet og stopper, når data er mærket med kvalitetsmærke KS2. Der henvises til Bilag 3 for et mere detaljeret kvalitetssikringsflow, som viser, at data kan få et fagligt forbehold samt mærkes med kvalitetsmærke KS3.

Nøgleoplysninger om de fag- og støttesystemer, der indgår i dataflowet, finder du i "[Oversigt over fag- og støttesystemer](#)".

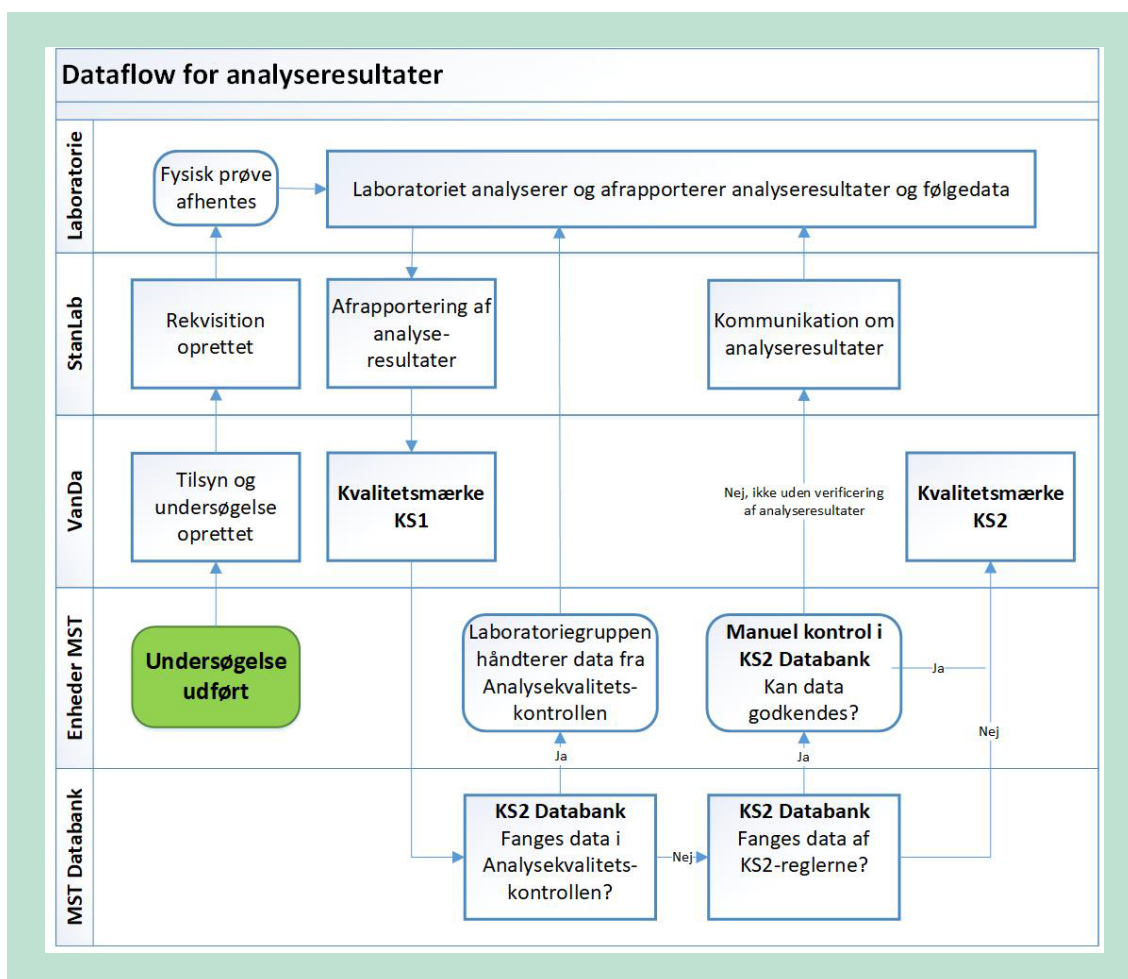


FIGUR 1. Dataflow for analyseresultater. Flowet starter ved den grønne boks "Undersøgelse udført" og læses fra venstre mod højre.

¹ Jf. definitionen i bilag 1

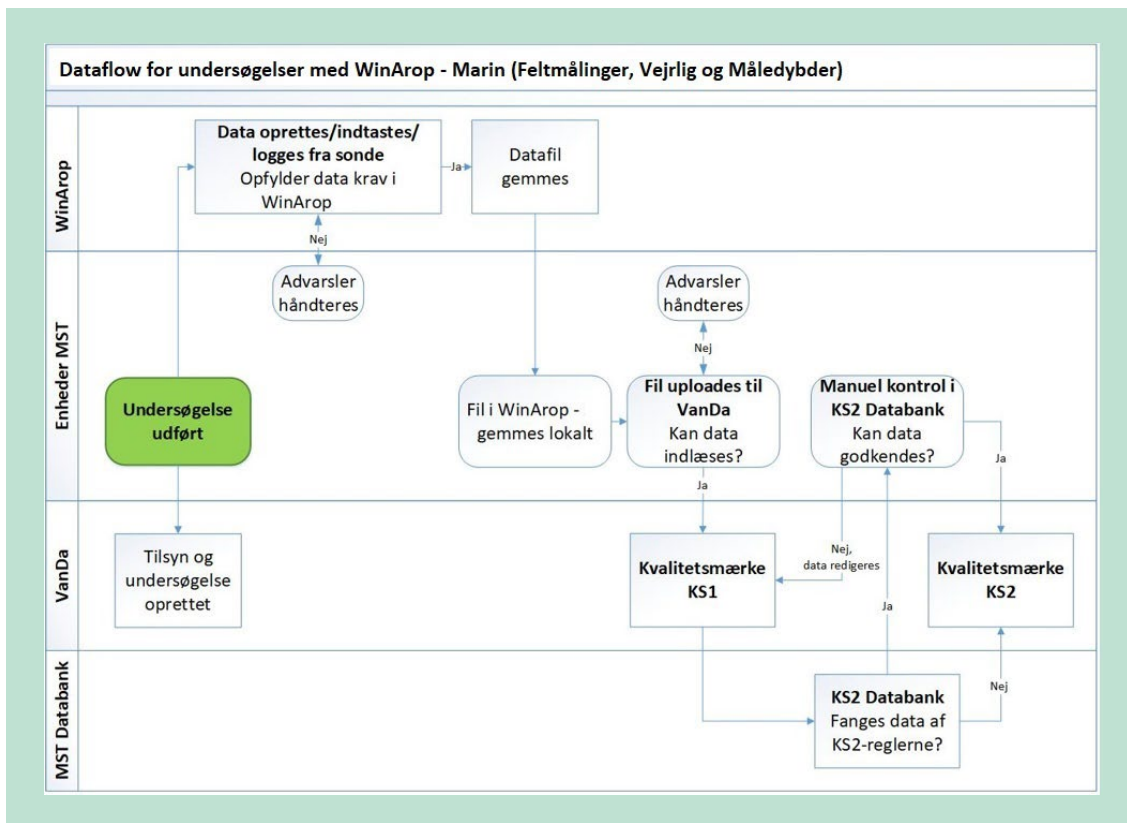

FIGUR 2. Dataflow for Feltmålinger opsamlet ved brug af WinArop. Flowet starter ved den grønne boks "Undersøgelse udført" og læses fra venstre mod højre.

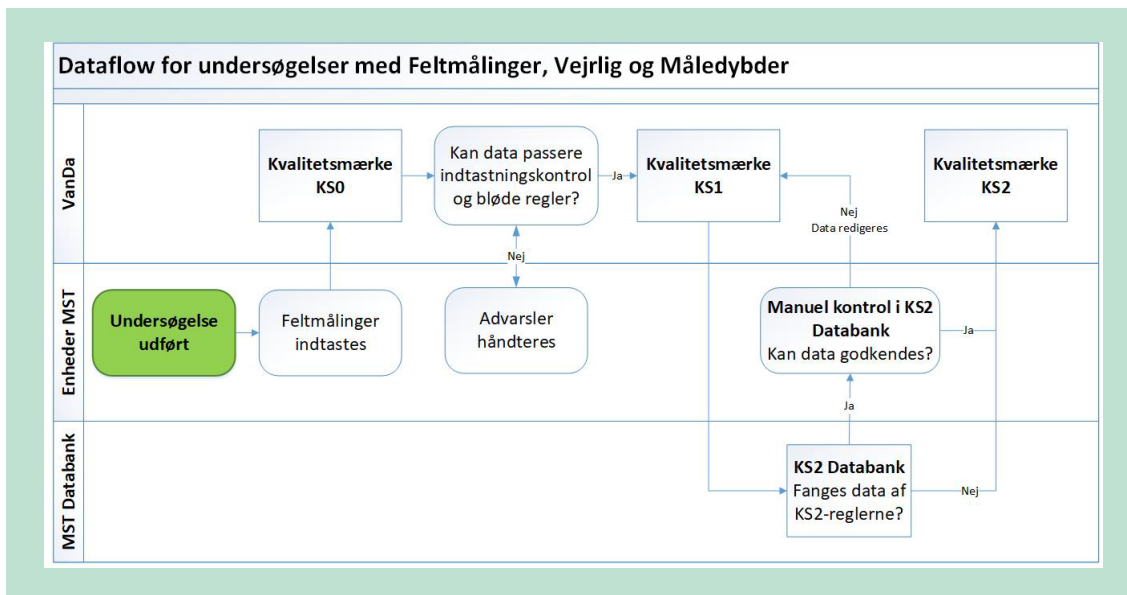

FIGUR 3. Dataflow for undersøgelsesemnerne Feltmålinger, Vejrlig og Måledybder som indtastes direkte i VanDa. Flowet starter ved den grønne boks "Undersøgelse udført" og læses fra venstre mod højre.

3. Indtastning/overførsel af data til inputsystem

I det følgende beskrives fremgangsmåden ved indtastning og indlæsning af data i VanDa for undersøgelsesemnerne marin Vandkemi og Feltmålinger, som omfatter undersøgelser beskrevet i de tekniske anvisninger (TA'er): M01 (Indsamling af vand- og planktonprøver i felten), M02 (Vandkemi), M03 (CTD måling), M04 (Ilt i vandsøjlen), M05 (Fluorescens), M06 (Lyssvækkelse) og M07 (Klorofyl a koncentration). Beskrivelsen omfatter ikke forhold, som fremgår af system-/brugervejledninger for VanDa, StanLab eller WinArop.


Du kan finde oplysninger om adgang, roller, brugervejledning, superbruger, systemejer mv. i "[Oversigt over fag- og støttesystemer](#)".

3.1 Indtastning af data og oprettelse af rekvisition

Inden du kan indtaste/indlæse data i VanDa, skal relevante stationer være oprettet i VanDa. Se afsnit 3.4 vedr. særskilt oprettelse af stationer/lokaliteter.

Det er vigtigt, at du fremsøger og vælger den korrekte station (unik stationsnummer), så data kan sammenholdes over tid.

Når du har valgt den korrekte station, skal du oprette et tilsyn, hvis dette ikke allerede er oprettet i forbindelse med anden undersøgelse på stationen. Herefter opretter du en undersøgelse for Vandkemi, hvorpå du kan oprette rekvisitioner. Når du overfører data fra sonde-programmet WinArop oprettes både tilsyn og undersøgelser automatisk for undersøgelsesemnerne Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig i VanDa. Alle obligatoriske felter (blå) i VanDa skal være udfyldt. Du skal tilknytte prøve(r) og efterfølgende oprette og indsende rekvisitioner til undersøgelsen. Det vil sige, at du skal vælge relevant(e) analysepakke(r) og angive beholdernummer. Du skal kontrollere, at data for alle de parametre, som skal indhentes i forbindelse med den konkrete undersøgelse og tilhørende metadata, er indtastet/indlæst. Af programbeskrivelsens parameterliste fremgår det, hvilke parametre undersøgelsesemnet omfatter. Du kan finde vejledning til udfyldelse af felter i VanDa og StanLab-rekvisitionen i VanDa-brugervejledningen. Når rekvisitionen er oprettet, skal du tjekke, at der er en kvittering på bestillingen (se Figur 4).



Laboratoriereference	Laboratorium	Besked	Status
835-2022-81090585	Eurofins Miljø A/S		Rekvisition bekræftet

FIGUR 4. Angivelse af, hvor i VanDa det kan tjekkes, om der er kvittering på bestilling af rekvisitionen.

Laboratoriet afrapporterer efterfølgende analyseresultaterne via StanLab, hvorefter de vil være tilgængelige i VanDa til MST's videre håndtering. Finder MST fejl i afrapporterede analyseresultater, er det kun laboratoriet, der kan rette i data og afrapportere på ny.

Data logges eller indtastes i WinArop – Marin's brugergrænseflade jf. Brugervejledningen. Advarsler håndteres løbende i WinArop - Marin, og den endelige fil indlæses i VanDa. Hvis advarsler i WinArop - Marin er håndteret korrekt, kan data indlæses i VanDa.

Såfremt der sker noget, som gør, at der er behov for at foretage sig noget manuelt under undersøgelsesemnerne: Vandkemi, Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig i VanDa, skal du sikre dig, at du, efter rettelserne er indført, får trykket på knappen "Afslut inddatering", som findes øverst på siden.

3.1.1 Bemærkningsfelter

I VanDa kan der angives en bemærkning på følgende niveauer:

- Undersøgelse
- Prøvetagning
- Prøve
- Analyseresultat
- Kvalitetssikring

Du må ikke angive bemærkninger på "Tilsyns" niveau, idet en bemærkning altid skal kunne henføres til en konkret undersøgelse.

I bemærkningsfeltet i VanDa skal du altid registrere evt. særlige forhold ifm. feltarbejdet, som kan have betydning for den videre behandling af data (fx. "prøven var grumset" eller "lysforholdene var dårlige"). Du skal også registrere, hvis en parameter mangler/ikke er målt, eller hvis der fx er anvendt en anden emballage end den, der er aftalt. Bemærkningen skal indsættes på det niveau af undersøgelsen, som bemærkningen vedrører. Hvis du indsætter en bemærkning på undersøgelses-, prøvetagnings- eller prøveniveau, vil undersøgelsen efterfølgende blive trukket ud til manuel kontrol i KS2 Databank. Dette betyder, at prøven ikke kan få kvalitetsmærke KS2, før MST har godkendt resultatet i KS2 Databank.

Ved målinger i WinArop - Marin skal du ligeledes altid indsætte bemærkninger, hvis der er særlige forhold, som kan have betydning for den videre behandling af data, eller hvis en parameter mangler osv. Bemærkninger i WinArop - Marin overføres til VanDa og kan ses i bemærkningsfeltet til selve undersøgelsen. Bemærkninger på dette niveau vil ligeledes medføre, at undersøgelsen trækkes ud til manuel kontrol i KS2 Databank. Bemærkninger vedr. Vandkemi, Vejrlig eller Måledybder skal noteres i VanDa under det aktuelle undersøgelsesemne.

Du må i udgangspunktet ikke bruge bemærkningsfelterne til at registrere oplysninger, som er uden betydning for den videre behandling af data, som fx oplysninger om lodsejer, mistanke om overtrædelser af div. bestemmelser o.l. Du må i udgangspunktet heller ikke notere særlige forhold vedr. stationen her, med mindre du vurderer, at de har betydning for databehandlingen.

Hvis du alligevel vurderer, at det er nødvendigt at skrive en bemærkning, som er uden betydning for den videre behandling af data, så start din tekst med en "stjerne" (*). Herved undgås, at din bemærkning giver anledning til manuel kontrol af data i KS2 Databank.

Hvis du har en bemærkning til laboratoriet, skal du udfylde feltet "Besked" på rekvisitionen. Bemærkninger til laboratoriet resulterer ikke i manuel kontrol i KS2 Databank, når prøveresultaterne afrapporteres.

3.2 Kontrol med manglende data

For analyseresultater skal du i MST's Leverancekontrol (KOMMER) sikre dig, at det bestilte antal analyser er afrapporteret af laboratoriet.

Hvis der er fejl i en leverance fra et laboratorium, skal du først tjekke, om laboratoriet har indsat en fyldestgørende forklaring på manglen i bemærkningsfelterne på analyseresultaterne i VanDa. Hvis det ikke er tilfældet, skal du følge laboratoriereferencen til StanLab og oprette en mail til laboratoriet via knappen "Send e-mail til laboratoriet" og bede dem udbedre manglen. Det er kun laboratoriet, som kan ændre i de rapporterede værdier.

Hvis der mangler data, og det skyldes, at MST ikke har udfyldt rekvisitionen korrekt, eller laboratoriet har mistet prøven, skal du undersøge, om der skal udtages en erstatningsprøve eller på anden måde afklare, hvordan fejlen kan udbedres. Kontakt i disse tilfælde Fagkoordinationsgruppe (FKG) Marin.

Hvis der mangler data i Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig, som ikke kan rettes ved at gå tilbage i WinArop – Marin og finde de relevante oplysninger, skal du undersøge om målingerne kan tages om.

Tab af data skal du notere i det relevante undersøgelsesemnes bemærkningsfelt i VanDa. Hvis hele undersøgelsen er tabt, og der ikke laves en erstatningsundersøgelse, skal du orientere FKG Marin herom.

3.3 Opbevaring af rådata

For undersøgelsesemnerne Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig kan alle indsamlede data rummes i fagsystemet. MST opbevarer således ikke rådata i forbindelse med undersøgelsesemner omfattet af denne dTA.

3.4 Oprettelse af stationer/lokaliteter

Inden data kan indtastes/indlæses, skal relevante stationer være oprettet i VanDa.

Ved sondemålinger skal du sikre, at de relevante stationer er indlæst fra VanDa til WinArop - Marin. Kontakt FKG Marin eller superbruger af WinArop - Marin for yderligere information.

Det er FKG Marin eller enhedens teamkoordinator, som varetager oprettelse af nye stationer. Kontakt derfor FKG Marin eller din teamkoordinator, hvis du skal lave en undersøgelse på en station, som endnu ikke er oprettet i VanDa.

3.5 Koder og dataudvekslingsformat

I Bilag 2 findes en oversigt over de væsentligste kodelister, som anvendes ifm. indtastning/overførsel af data fra overvågningen af Vandkemi, Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig til VanDa.

I forbindelse med kontraktindgåelse med et laboratorium, opretter laboratoriet relevante analysepakker i StanLab, og det sikres, at alle stoffer fremgår af Stancode-liste 1008. Når MST har godkendt analysepakkerne, kan analysepakkerne vælges under rekvisitioner og afrapporteres til VanDa.

Hvis du skal bestille parametre, der ikke er indgået aftale om i en godkendt StanLab-analyse-pakke med et laboratorium, skal du først have accept af bestillingen fra FKG Marin.

Ved sondemålinger skal du sikre, at de relevante parametre/koder er indlæst fra VanDa. Kontakt FKG Marin eller superbruger af WinArop – Marin for yderligere information.

4. Kvalitetssikring

I det følgende beskrives de forskellige kvalitetssikringstrin, som undersøgelser i VanDa, der er indsamlet under NOVANA-programmet, gennemgår.

Dataflowet ifm. den samlede kvalitetssikring af data fra overvågningen af Vandkemi, Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig er vist i Figur 1, 2 og 3 i afsnit 2.

Du kan finde oplysninger om adgang, systemvejledning, superbruger, systemejer mv. for KS2 i ["Oversigt over fag- og støttesystemer"](#).

4.1 Kvalitetssikringsflow

4.1.1 Kvalitetsmærker og forbehold i VanDa

Data i VanDa for undersøgelser med analyseresultater kan have kvalitetsmærkerne KS1, KS2 og KS3 (se Tabel 1 eller det detaljerede kvalitetssikringsflow i Bilag 3).

TABEL 1. Oversigt over de forskellige niveauer af kvalitetsmærker for analyseresultater.


Kvalitetsmærke	Betingelse
KS1	Analyseresultaterne er indlæst via StanLab i VanDa.
KS2	Analyseresultaterne har passeret Analyse kvalitetskontrol og undersøgelsesemnets KS2-regler (se afsnit 4.3) efter enten automatisk godkendelse eller efter manuel håndtering af KS2-advarsler.
KS3	Hvis FDC's kvalitetssikring af analyseresultaterne resulterer i godkendelse af data.

Data kan derudover have påsat et fagligt forbehold (se Tabel 2, afsnit 4.3.3 samt det detaljerede kvalitetssikringsflow i Bilag 3). Fagligt forbehold kan være i form af KS2 forbehold, som betyder, at data ikke kan opnå kvalitetsmærke KS2, før forbeholdet er fjernet, eller KS3 forbehold, som betyder, at data ikke kan opnå kvalitetsmærke KS3, før forbeholdet er fjernet.


TABEL 2. Oversigt over de to forskellige forbehold, og beskrivelse af, hvornår de sættes.

Forbehold	Betingelse
KS2 forbehold	Hvis MST's kvalitetssikring af analyseresultatet resulterer i, at MST ikke kan godkende data, men at det heller ikke kan dokumenteres, at data er forkert.
KS3 forbehold	Hvis FDC's kvalitetssikring af analyseresultatet resulterer i, at FDC ikke kan godkende data.

Du finder kvalitetsmærket i VanDa for undersøgelsesemner med analyseresultater på niveauet "Resultater" (se Figur 5). Når du har trykket dig ind på kvalitetsmærket kan du se, om data har enten KS2 forbehold eller KS3 forbehold (se Figur 6)

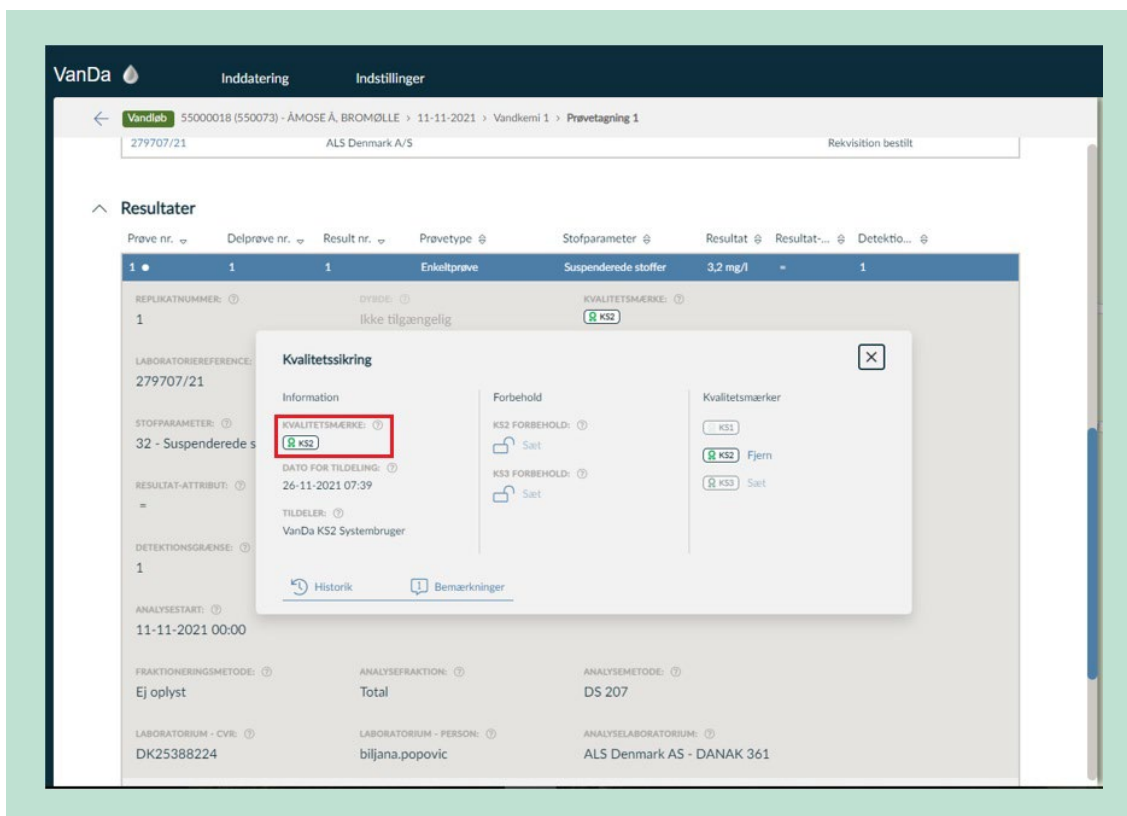

FIGUR 5. Angivelse af, hvor kvalitetsmærket fremgår i VanDa for undersøgelsesemner med analyseresultater.

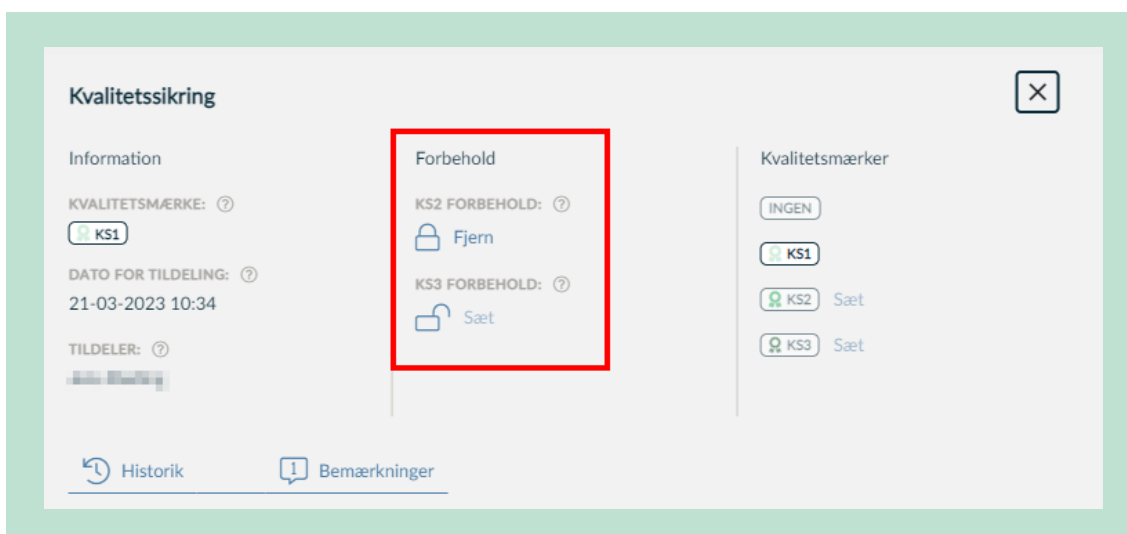

FIGUR 6. Angivelse af, hvor fagligt forbehold findes. I dette eksempel, er der taget KS2 forbehold, hvilket betyder, at data ikke kan opnå kvalitetsmærke KS2, før forbeholdet er fjernet.

Data i VanDa for undersøgelsesemnerne Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig kan have kvalitetsmærkerne KS0, KS1, KS2 og KS3. (se Tabel 3 eller det detaljerede kvalitetssikringsflow i Bilag 3). Data indlæst fra sonden får kvalitetsmærket KS1, da en KS0 fejlhåndtering foretages i selve sondeprogrammet WinArop - Marin.


TABEL 3. De forskellige niveauer af kvalitetsmærker for undersøgelsesemnerne Feltmålinger, Vejrlig og Måledybder.

Kvalitetsmærke	Betingelse
KS0	Data er indtastet i VanDa, men indtastningen er endnu ikke afsluttet, fx. fordi der er fejl i inddateringen, som først skal håndteres.
KS1	Alle obligatoriske data er indlæst og indtastet, data lever op til valideringerne, som er fastlagt i VanDa (se 4.2), og inddateringen er afsluttet.
KS2	Data har passeret undersøgelsesemnets KS2-regler (se afsnit 4.3) efter enten automatisk godkendelse eller efter manuel kvalitetskontrol og godkendelse.
KS3	FDC's kvalitetssikring er gennemført, og data er godkendt.

Kvalitetsmærkerne KS2 og KS3 kan derudover have et fagligt forbehold (se Tabel 2 og afsnit 4.3.3). For Feltmålinger gælder det særlige, at kvalitetsmærket omfatter alle parametre, der indgår i feltmålingen. Hvis du tager et fagligt forbehold for en feltmåling, vil alle parametre i feltmålingen være omfattet heraf. Det betyder bl.a., at iltdata fra feltmålingen ikke vil indgå i ilt-rapporteringen, hvis der er taget et fagligt forbehold for feltmålingen. Hvis det er nødvendigt at tage et fagligt forbehold for kvaliteten af en feltmåling, skal du derfor hurtigst muligt sørge for at få afklaret det, der har affødt forbeholdet, og herefter få fjernet forbeholdet. Det er særligt vigtigt at få fjernet faglige forbehold fra Feltmålinger i iltsvindperioden. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt data er fejlbehæftede og derfor skal slettes fra VanDa, kan du rette henvendelse til FKG Marin.

Data indlæst fra sonden får kvalitetsmærket KS1, da en KS0 fejlhåndtering foretages i selve sondeprogrammet WinArop - Marin. Data, der optræder med KS0, er typisk udtryk for, at inddateringen ikke er blevet afsluttet, og det skal du så sørge for at få gjort i VanDa.

Du finder kvalitetsmærket i VanDa for sondemålinger og undersøgelsesemnerne Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig på undersøgelsesniveauet (se eksempel i Figur 7).

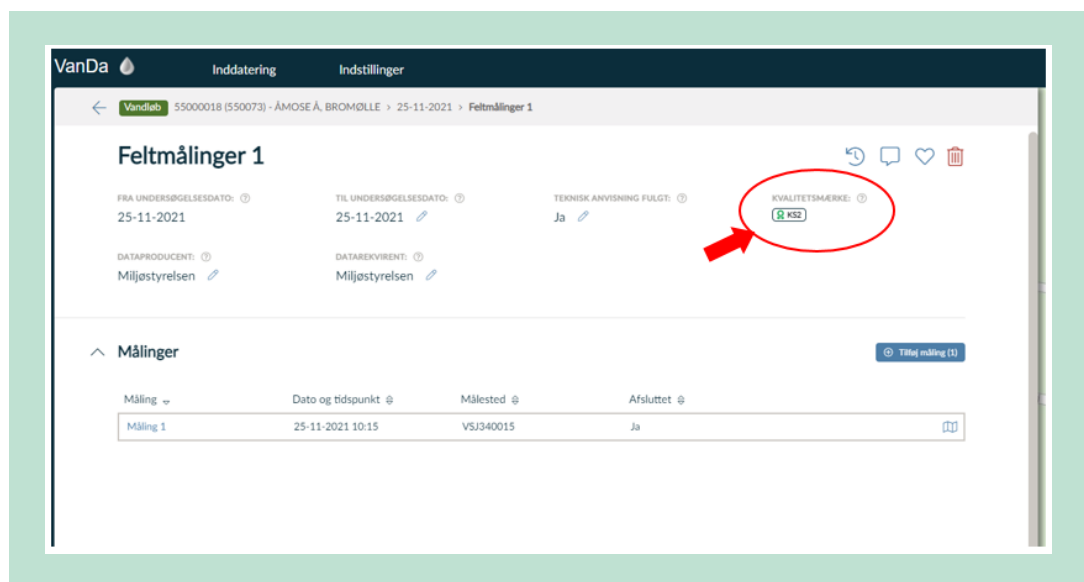

FIGUR 7. Eksempel på angivelse af, hvor kvalitetsmærket for Feltnmålinger fremgår i VanDa.

4.1.2 Redigering af undersøgelser

Hvis du redigerer i en undersøgelse med Feltmålinger, Måledybder eller Vejrlig, sættes kvalitetsmærket tilbage til KS0. Når du har trykket på "afslut inddatering" øverst på siden, sættes kvalitetsmærket til KS1.

Hvis du redigerer i en undersøgelse med analyseresultater, og analyseresultaterne har et højere kvalitetsmærke end KS1, sættes kvalitetsmærket tilbage til KS1 for alle undersøgelsens analyseresultater, og kvalitetssikringen starter forfra. Dette sker ikke, hvis redigeringen alene består i, at du indsætter en bemærkning.

4.1.3 Genafrapporterede analyseresultater

Kvalitetsmærkerne sættes tilbage til KS1, hvis laboratoriet genafrapporterer resultater på en prøve. KS2 Databank vil efterfølgende automatisk KS2-mærke analyseresultater, som er genafrapporteret med samme værdi, hvis resultatet før genafrapportering havde kvalitetsmærke KS2. Genafrapporterede analyseresultater med ændrede værdier sendes gennem Analyse-kvalitetskontrollen og undersøgelsesemnets KS2-regler (se afsnit 4.3).

Ved genafrapporteringen af analyseresultater slettes tidligere anførte bemærkninger på resultat- og kvalitetssikringsniveau kun på ændrede analyseresultater.

4.1.4 Laboratorieanalyser rekvireret fra laboratorie

Når du opretter en rekvirition på en laboratorieanalyse i VanDa, sendes rekviritionen til laboratoriet via StanLab. Når laboratoriet sender analyseresultaterne tilbage, sker det ligeledes via StanLab til VanDa. Analyseresultater, som ikke opfylder valideringsreglerne for indlæsning i VanDa (se afsnit 4.2), afvises og gemmes ikke i VanDa. Analyseresultater, som ikke afvises, gemmes i VanDa og opnår derved kvalitetsmærke KS1. Laboratoriet kan godt afrapportere andre eller færre parametre end aftalt i analysepakkerne. Kontrol af laboratoriernes afrapporteringer finder sted i modulerne Leverancekontrol (KOMMER) og Analyse-kvalitetskontrol (se afsnit 4.3.1).

4.1.5 Overførsel af data fra VanDa til KS2 Databank

Data overføres fra VanDa (via distributionsdatabasen) til MST Databank hver nat, hvor alle analyseresultater og tilhørende metadata med kvalitetsmærke KS1 underkastes Analyse-kvalitetskontrollens regler (se afsnit 4.3.1). Data, som passerer Analyse-kvalitetskontrollen, underkastes herefter de enkelte undersøgelsesemners KS2-regler i KS2 Databank (se afsnit 4.3.2). Data, som fanges af regler i enten Analyse-kvalitetskontrol eller KS2 Databank, forbliver med kvalitetsmærke KS1 i VanDa, indtil advarsler er håndteret (se afsnit 4.3.3).

4.2 Indtastnings- og indlæsningskontrol samt valideringer i WinArop – Marin og VanDa (KS1)

Hvis du indtaster data i undersøgelsesemnerne Vandkemi, Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig direkte i VanDa jf. dataflowet i Figur 1 og 3, sker der en indtastningskontrol (KS1) af de indtastede data, og i nogle felter kan du kun vælge mellem få og relevante indtastningsmuligheder. For de enkelte felter i VanDa kan der være opsat krav til indhold/værdier, som gør, at du ikke kan gå videre til næste felt, hvis din indtastning fanges i en validering.

Når laboratoriet afrapporterer analyseresultater på oprettede rekviritioner, bliver resultater og tilhørende metadata valideret i VanDa's automatiske indlæsningskontrol. Hvis data ikke lever op til den krævede struktur, afvises data.

Resultater og data (Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig), du indtaster, eller som logges via sonden til programmet WinArop - Marin, gennemgår en KS1 validering, som i VanDa. Kun godkendte data kan gemmes i WinArop - Marin. WinArop - Marin udfører også en simpel statistisk behandling af data, f.eks. hvis et resultat afviger i forhold til tidligere målte maksimum- og minimumsværdier inden for kvartalet på stationen. Der gives kun advarsler om evt. afvigelser i forhold til dette, men data afvises ikke. Du retter eller korrigerer afviste evt. afvigende data/resultater (f.eks. pga. fejl i sensor) på lokaliteten ved undersøgelsen. Ved indlæsning af data og resultater fra WinArop - Marin's eksport-fil til VanDa gentages KS1 validering af data i VanDa, og kun godkendte data kan endeligt indlæses i VanDa.

Opdatering af KS1-reglerne samt statistikker til WinArop - Marin foretages af FKG Marin og WinArop - Marin superbruger.

4.3 Kvalitetssikring i KS2 Databank – Analysekvalitetskontrol og KS2-regler

4.3.1 Analysekvalitetskontrol

Analyseresultater, som har kvalitetsstatus KS1 i VanDa, underkastes Analysekvalitetskontrol efter overførsel til KS2 Databank. Alle andre undersøgelsesemner underkastes ikke Analyse-kvalitetskontrol, men ledes direkte til KS2-reglerne. Analyse-kvalitetskontrollen tjekker enheder, analysemetoder, usikkerheder, dubletter og andre uoverensstemmelser i data, som alene skyldes fejl i leverancer eller struktur. Reglerne for Analyse-kvalitetskontrollen finder du i "[Oversigt over regler i KS2 Databank](#)".

Data, der fanges i Analyse-kvalitetskontrollen, håndteres af MST's laboratorieggruppe, som enten tilretter Analyse-kvalitetskontrollen eller beder laboratoriet om at genafrapportere i et korrekt format. Du kan tilgå Analyse-kvalitetskontrollen via KS2-brugergænsefladen i KS2 Databank, hvor du kan se, hvilke data der ligger til kontrol.

Analyseresultater, som passerer Analyse-kvalitetskontrollen, underkastes efterfølgende de faglige KS2-regler.

4.3.2 KS2-regler og automatisk godkendelse

De undersøgelses-specifikke KS2-regler finder du i "[Oversigt over regler i KS2 Databank](#)".

Analyseresultater KS2-godkendes automatisk i VanDa, hvis de passerer Analyse-kvalitetskontrollen og derefter undersøgelsesemnets KS2-regler.

Undersøgelser med analyseresultater, hvor laboratoriet genafrapporterer et analyseresultat, som tidligere har været KS2-godkendt, og hvor resultat og detektionsgrænse er det samme, fanges af KS2 Databank i modulet Laborateduplikater, og sendes ikke gennem KS2-reglen igen, men mærkes i stedet med kvalitetsmærket KS2 i VanDa.

Feltmålinger, Måledybder og Vejrlig KS2-godkendes automatisk i VanDa, hvis de passerer undersøgelsesemnets KS2-regler.

Data, som falder for en KS2-regel, trækkes ud til manuel kontrol (se 4.3.3).

4.3.3 Manuel håndtering af data i KS2 Databank

Data, der falder for en eller flere KS2-regler, trækkes ud til manuel kontrol i KS2 Databank. Her kan data håndteres, hvilket vil sige, at data enten godkendes eller får et fagligt forbehold (KS2 forbehold). Data kan også slettes eller redigeres på baggrund af advarslen. Hvis data ændres, vil det skulle passere de opsatte KS2-regler endnu engang.

Data, der falder for en eller flere KS2-regler, vil ikke komme videre i dataflowet for MST's kvalitetssikring, før advarslen er håndteret, eller data er ændret/slettet, så det ikke længere trækkes ud til manuel KS2-kontrol. Link til brugervejledning til KS2 Databank finder du i "[Oversigt over fag- og støttesystemer](#)"

Du skal håndtere alle de manuelle kontroller i KS2 Databank for de undersøgelsesemner og geografiske områder, du er ansvarlig for. For enkelte parametre er der en deadline for, hvornår denne håndtering skal have fundet sted. Disse deadlines kan du finde på Overvågningsintranettet (OVI) under ODAG.


Data, som falder for et forkastelseskrav, præsenteres i tabeloversigten i KS2-brugergrænsefladen. Når du tilgår de enkelte advarsler fra listen, præsenteres du for en række oplysninger, som skal bruges til håndtering og vurdering af data. Du kan finde en konkret beskrivelse af de enkelte KS2-regler og håndteringen af disse under "Dokumentation" i KS2 Databank.

Hvis du ikke selv har stået for indsamling af de konkrete feltdata/prøver, som bliver fanget i KS2-kontrollen, og årsagen ikke umiddelbart kan fastlægges, skal du kontakte den person, som har foretaget indsamlingen, for at høre, om vedkommende kan bidrage med relevante oplysninger.

Hvis du i forbindelse med vurdering af analyseresultater vil kontakte analyselaboratoriet, skal du forinden kontrollere indholdet i den relevante analyserekvitation i StanLab og undersøge om laboratoriet har indsat bemærkninger til analyseresultatet i VanDa. Hvis du derefter stadig vurderer, at der er behov for at få belyst resultatet nærmere, skal du henvende dig til laboratoriet via mailfunktionen i StanLab for berørte laboratoriereference. Her kan du bede dem tjekke kørselsdata mv. for den pågældende analyse. På baggrund af dialogen med laboratoriet skal du dernæst, hvis det er muligt for den pågældende parameter, beslutte, om du vil bestille en reanalyse.

Analyseresultater

For analyseresultater gælder det, at hvis du godkender, tager et fagligt forbehold eller sletter data (for at slette analyseresultater kræves der administratorrettigheder til VanDa), og det ikke skyldes generelle forhold, som folk med faglig indsigt i området må formodes at kende til, skal du notere dine overvejelser/begrundelser og konklusioner i bemærkningsfeltet under kvalitetsmærket, som findes på niveauet "Resultater" (se Figur 8). Fx "Der er foretaget reanalyse, og resultaterne var ens, hvorfor data godkendes", "Data underkastes et fagligt forbehold, da undersøgelsen vurderes at være gennemført korrekt, men værdien ligger uden for xxx intervallet" eller "Data slettes, da sonden har vist sig at være gået i stykker på prøvetagningstidspunktet, og der ikke er tale om en systematisk fejl, hvor det er muligt at skønne den reelle værdi". Hvis du tager et fagligt forbehold via KS2 Databank, indsættes den påkrævede bemærkning automatisk i VanDa og resultatet får påsat KS2 forbehold (se Figur 6). Data med et fagligt forbehold kan ikke efterfølgende tildeles kvalitetsmærker på et højere niveau, uden du først har fjernet forbeholdet.

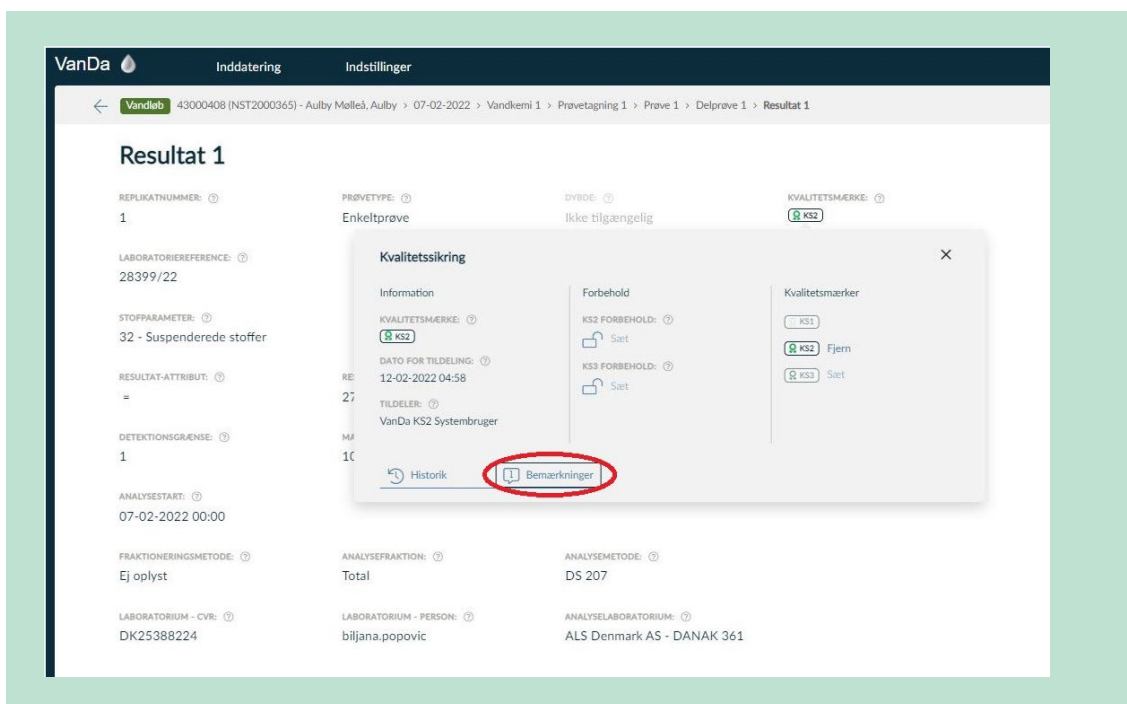


FIGUR 8. Angivelse af placering af bemærkningsfeltet til kvalitetsmærket i VanDa.

Feltmålinger og biologiske undersøgelser

For de forskellige feltmålinger og biologiske undersøgelser gælder det, at hvis du godkender, tager et fagligt forbehold, ændrer eller sletter data, og det ikke skyldes generelle forhold, som folk med faglig indsigt i området må formodes at kende til, skal du notere dine overvejelser/begrundelser og konklusioner i bemærkningsfeltet under kvalitetsmærket, som findes på undersøgelsesniveauet (se Figur 9). Fx: "Afvigelsen vurderes at skyldes den varme vejrperiode, som har givet anledning til store frigivelser af fosfor fra søbunden, hvorfor data godkendes", "Data underkastes et fagligt forbehold, da undersøgelsen vurderes at være gennemført korrekt, men værdien ligger uden for xxx intervallet" eller "Data slettes, da sonden har vist sig at være gået i stykker på prøvetagningstidspunktet, og der ikke er tale om en systematisk fejl, hvor det er muligt at skønne den reelle værdi". Hvis du tager et fagligt forbehold via KS2 Databank, indsættes den påkrævede bemærkning automatisk i VanDa og resultatet får påsat KS2 forbehold (se Figur 6). Data med et fagligt forbehold kan ikke efterfølgende tildeles kvalitetsmærker på et højere niveau, uden du først har fjernet forbeholdet.


For marine Feltmålinger må et forbehold kun bestå i kort tid, idet et fagligt forbehold vil bevirke at alle parametre i feltmålingen ikke vil kunne opnå kvalitetsmærket KS2. Hvis der fx er taget et fagligt forbehold for en marin feltmåling, som kunne handle om lysmålingerne, så vil iltmålingerne, som måske er helt fine, ikke kunne indgå i iltsvindsrapporteringen. Løsningen er at få afgjort, hvorvidt de data, der udløser forbeholdet, enten er gode nok til, at data kan blive i VanDa, eller om de er så dårlige, at de skal slettes, hvorefter forbeholdet fjernes. I givet fald, at der slettes data, noteres dette i bemærkninger til feltmålingen, hvor årsagen til, at data er fjernet, angives.

I øjeblikket er der en uheldig omstændighed i KS2 Databank, som gør, at du er nødt til at godkende hver enkelt måling ned igennem profilet, når en Kd værdi udtages til manuel håndtering. Da denne arbejdsgang tager uforholdsmæssig lang tid, skal du i disse tilfælde i stedet sætte kvalitetsmærket til KS2 direkte i VanDa. Advarslen vil dermed forsvinde fra KS2 Databank dagen efter, og feltmålingen vil ikke blive ledt igennem reglerne i KS2 Databank. Du skal derfor kun gøre dette, hvis du er sikker på, at alle data i feltmålingen lever op til KS2-niveauet.

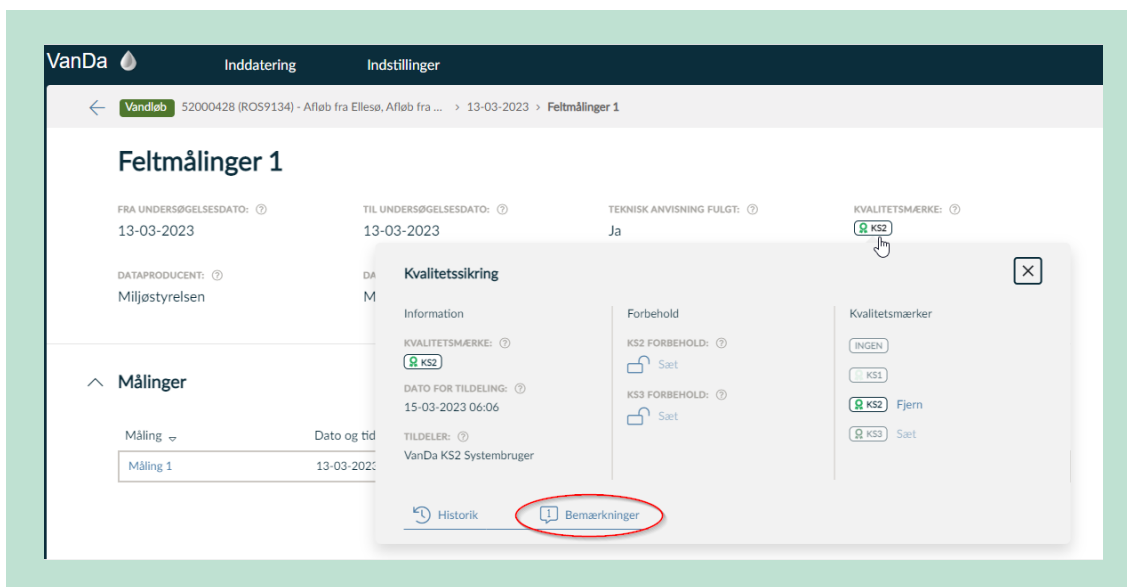

FIGUR 9. Angivelse af placering af bemærkningsfeltet til kvalitetsmærket for de forskellige feltmålinger og biologiske undersøgelser i VanDa.

Du skal undlade at bruge bemærkningsfeltet for analyseresultatet (se Figur 10), da dette bemærkningsfelt som udgangspunkt er forbeholdt bemærkninger fra laboratoriet. Undtagelsen er, hvis du som KS2-medarbejder har brug for at kommentere på en allerede indsat bemærkning fra laboratoriet. Bemærkninger indsat på analyseresultat-niveau og på kvalitetsmærke-niveau vil ikke give anledning til manuel kontrol i KS2 Databank efterfølgende.

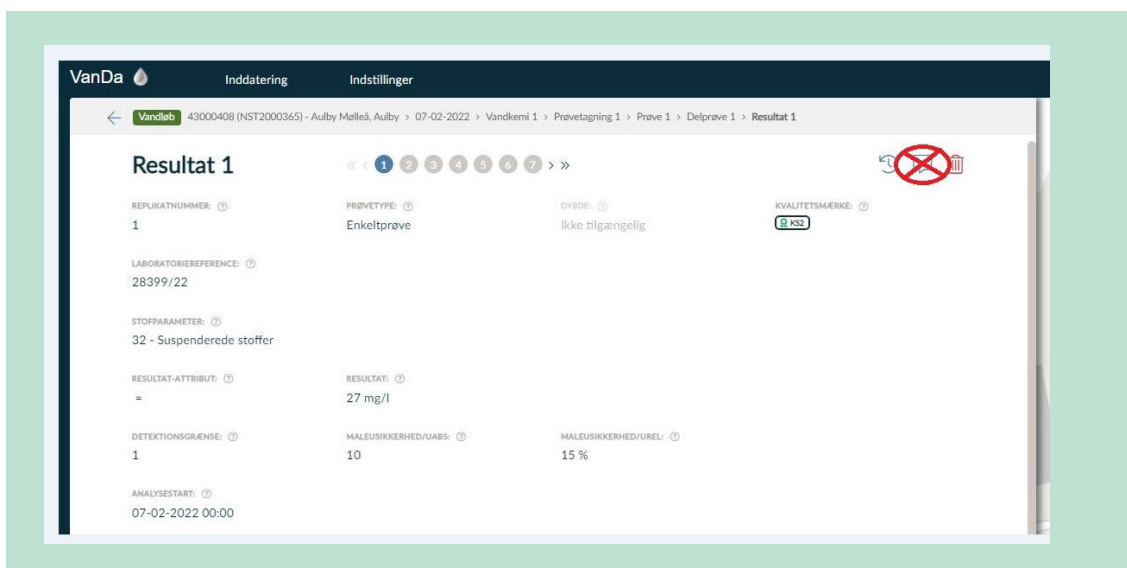

FIGUR 10. Angivelse af placering af bemærkningsfeltet for analyseresultater i VanDa. Bemærkningsfeltet er forbeholdt bemærkninger fra laboratoriet.

Data skal slettes, hvis du har dokumentation for, at der er sket fejl i enten felt, laboratorium eller ifm. databehandlingen, som kan have betydning for datakvaliteten, og hvor det ikke er muligt at rette op på fejlene, (fx at en prøve ikke blev konserveret korrekt). Data skal ligeledes slettes, hvis der er usikkerheder/uklarheder/mangler ifm. det gennemførte arbejde i felt eller laboratorium eller ifm. den foretagne databehandling, som du ikke kan afklare eller udbedre, og hvor usikkerheden/uklarheden/manglen betyder, at data ikke kan anvendes, (fx at der er

opstået tvivl om, hvilken station data vedrører, eller fra hvornår et måleinstrument holdt op med at virke, som det skulle).

Hvis du retter data pga. fx fejl ved indtastning og/eller overførsel af data, fejl i korrektioner eller beregninger eller fejl ved måleudstyr, nulstilles kvalitetsmærkerne og kvalitetssikringsprocessen starter forfra. Tilsvarende gælder, når data overskrives pga. en reanalyse foretaget af et kemisk analyselaboratorie.

Hvis rettelserne omfatter andet end simple fejl, (fx at der er indtastet forkerte værdier), skal du notere (i bemærkningerne/dokumenter, du journaliserer), at der er tale om ændrede data og begrundelsen for ændringen.

Hvis du konstaterer, at der mangler data fra en konkret undersøgelse, skal du følge fremgangsmåden beskrevet i afsnit 3.2.

Bilag 1. Anvendte begreber

Autoritative data: Data, der er fremkommet og behandlet i overensstemmelse med anvisningerne i relevante TA'er og dTA'er. Autoritative data er bl.a. kontrollerede og deklarerede i muligt omfang.

Bemærkning: Se "Deklarering af data".

Databehandling: Databehandling omfatter i dTA'ens forstand alle eller udvalgte aktiviteter, som kan foregå i forskellig rækkefølge, ifm. indtastning eller overførsel af data til støtte- eller fagsystemer, korrektion af målte/observerede eller beregnede værdier, beregning af nye størrelser, som fx indeks, eller ifm. kvalitetskontroller af disse data på forskellige niveauer på vejen fra felt til fagsystem.

Dataemne: Alle data, herunder korrigerede og beregnede, fra en type undersøgelse udtaget på alle programsatte stationer/lokaliteter i regi af et NOVANA-delprogram. Fx alle data fra vegetationsundersøgelser i vandløb, vandkemi og feltmålinger fra stoftransportstationer eller overvågning af en bestemt art.

Deklarering af data:

Omfatter:

- **Kvalitetsmærkning:** Oplysning om dels hvilket niveau i kvalitetssikringsprocessen data er kvalitetssikret til, dels hvad status er for kvalitetssikringen på det pågældende niveau (i VanDa kan kvalitetsmærkning være KS0, KS1, KS1 med forbehold (kaldes også KS2 forbehold), KS2, KS2 med forbehold (kaldes også KS3 forbehold) og KS3.
- **Bemærkninger:** Oplysninger i fagsystemet, som kan knyttes til et specifikt tilsyn, prøve, resultat mv. Bemærkninger anvendes:
 - Til at gøre opmærksom på særlige forhold ved prøvetagningen, der har betydning for den videre databehandling (se afsnit 3.1.1).
 - I forbindelse med databehandling og kvalitetssikring som forklaring af, hvorfor afvigende data er godkendt, har fået fagligt forbehold eller er slettet (se afsnit 4.3.3).
 - Til oplysninger om korrektionsformler og henvisning til faglige rapporter for korrigerede data

Fagsystem: Database med brugergrænseflader til fx dataindlæsning, kvalitetssikring, korrektion, beregning og dataudtræk, hvor MST gemmer autoritative data. I dette tilfælde er det VanDa, der er fagsystemet.

Indtaste data: Input af data i et støtte- eller fagsystem vha., en smartphone, en feltablet, en kontor pc eller lign.

Inputsysteem: Det støtte- eller fagsystem, hvortil feltdata og kemiske analyseresultater mv. indtastes/overføres indledningsvist. I dette tilfælde er det WinArop, der er det relevante støtte-system til håndtering af feltmålinger.

Kvalitetsmærkning: Se "Deklarering af data".

Metadata: Oplysninger tilknyttet indsamlede rådata, om fx tid, sted, prøvetager o.lign.

MST Databank: Den egentlige database, som blandt andet indeholder alle oplysninger fra VanDa. Det er fra MST Databank data trækkes til kvalitetssikring i KS2 Databank og til offentliggørelse på Miljøportalen.

Overføre data: Flytning af data fra fx et program eller et måleapparat til et støtte- eller fagsystem, uanset om dette sker manuelt eller automatisk.

Parameter: En bestemt størrelse, der kan måles eller observeres (fx totalfosfor, sigtddyden på en station eller en registreret art).

Rådata: Ikke korrigerede eller beregnede data, der enten er indsamlet/målt i felten og noteret manuelt (på papir), eller som er registreret automatisk (fx med logger eller på video) eller analyseresultater fra laboratoriet. Nogle rådata overføres automatisk til inputsystem.

Støttesystem: Program, der understøtter de digitale processer ifm. fx overførsel af data, korrektion og beregning af data samt udtræk og visning af data, fx software-robotter, værktøjer til (semi-)automatisk kvalitetssikring eller værktøjer til at konvertere data.

Undersøgelse: En struktur af meningsfuldt sammenhængende parametre indsamlet på et bestemt tidspunkt på samme station/lokalitet, til brug ved vurdering/beregning af en tilstand, påvirkning, bestandstørrelse eller andet på stationen/lokaliteten. Undersøgelsen kan udføres en gang eller flere gange årligt og omfatter både feltmålinger, kemiske analyseresultater fra indhentede prøver og registreringer af forskellige forhold i felten.

Undersøgelsesemne: De emner, der kan vælges inden for et medie (fx Marin eller Vandløb), når en undersøgelse skal indtastes i VanDa. Fx Feltmålinger, Fisk eller Vandkemi. Et dataemne kan godt bestå af flere undersøgelsesemner. Fx indeholder dataemnet 'Marin Vandkemi og Feltmålinger' undersøgelsesemnerne Feltmålinger, Måledybder, Vandkemi og Vejrlig.

Bilag 2. Kodelister


Nedenstående Stancode-lister anvendes ifm. behandling af data, som er omfattet af nærværende dTA. Se evt. afsnit 3.5 om oprettelse af koder.

TABEL 4. Oversigt over de Stancode-lister, som indgår i denne dTA.


Kodelisterne findes på DCE's hjemmeside: <http://dce.au.dk/overvaagning/stancode/>.

Kodeliste nummer	Kodeliste navn
1005	Prøvetype
1006	Udstyr
1008	Parameter
1009	Måleenhed
1011	Analysemetode
1030	Prøvefraktion
1035	Højdereference
1036	Skydække
1037	Vejr
1038	Vindstyrke
1040	Istykkelse
1135	Måleudstyr


Bilag 3. Detaljeret kvalitetssikringsflow

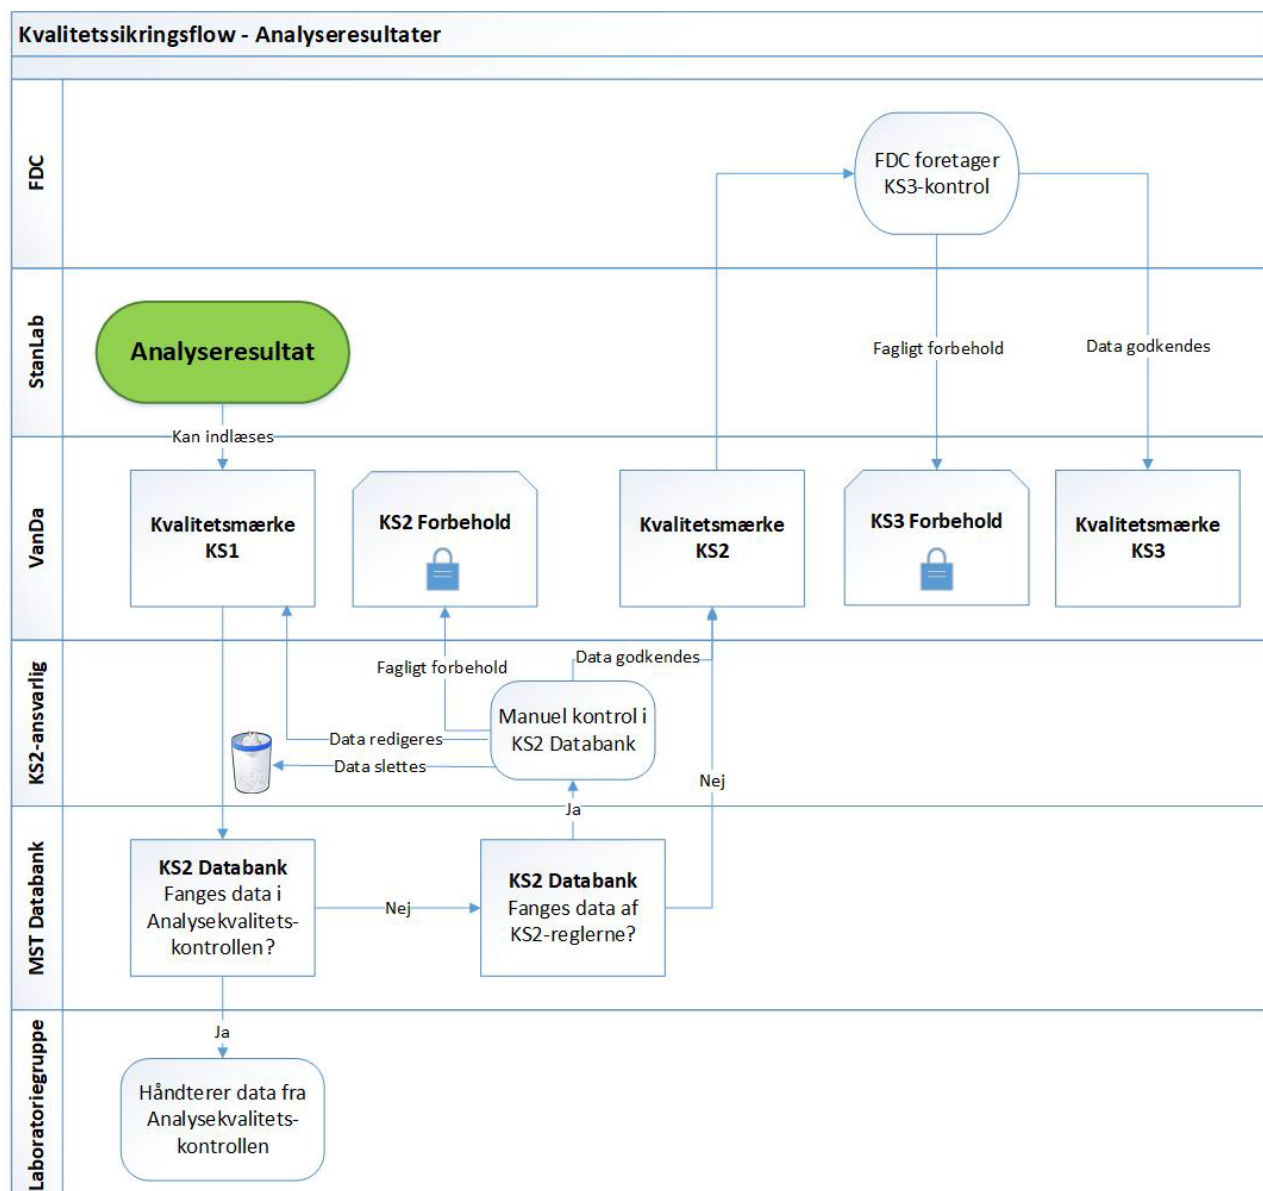

Kvalitetssikringsflow - Feltmålinger

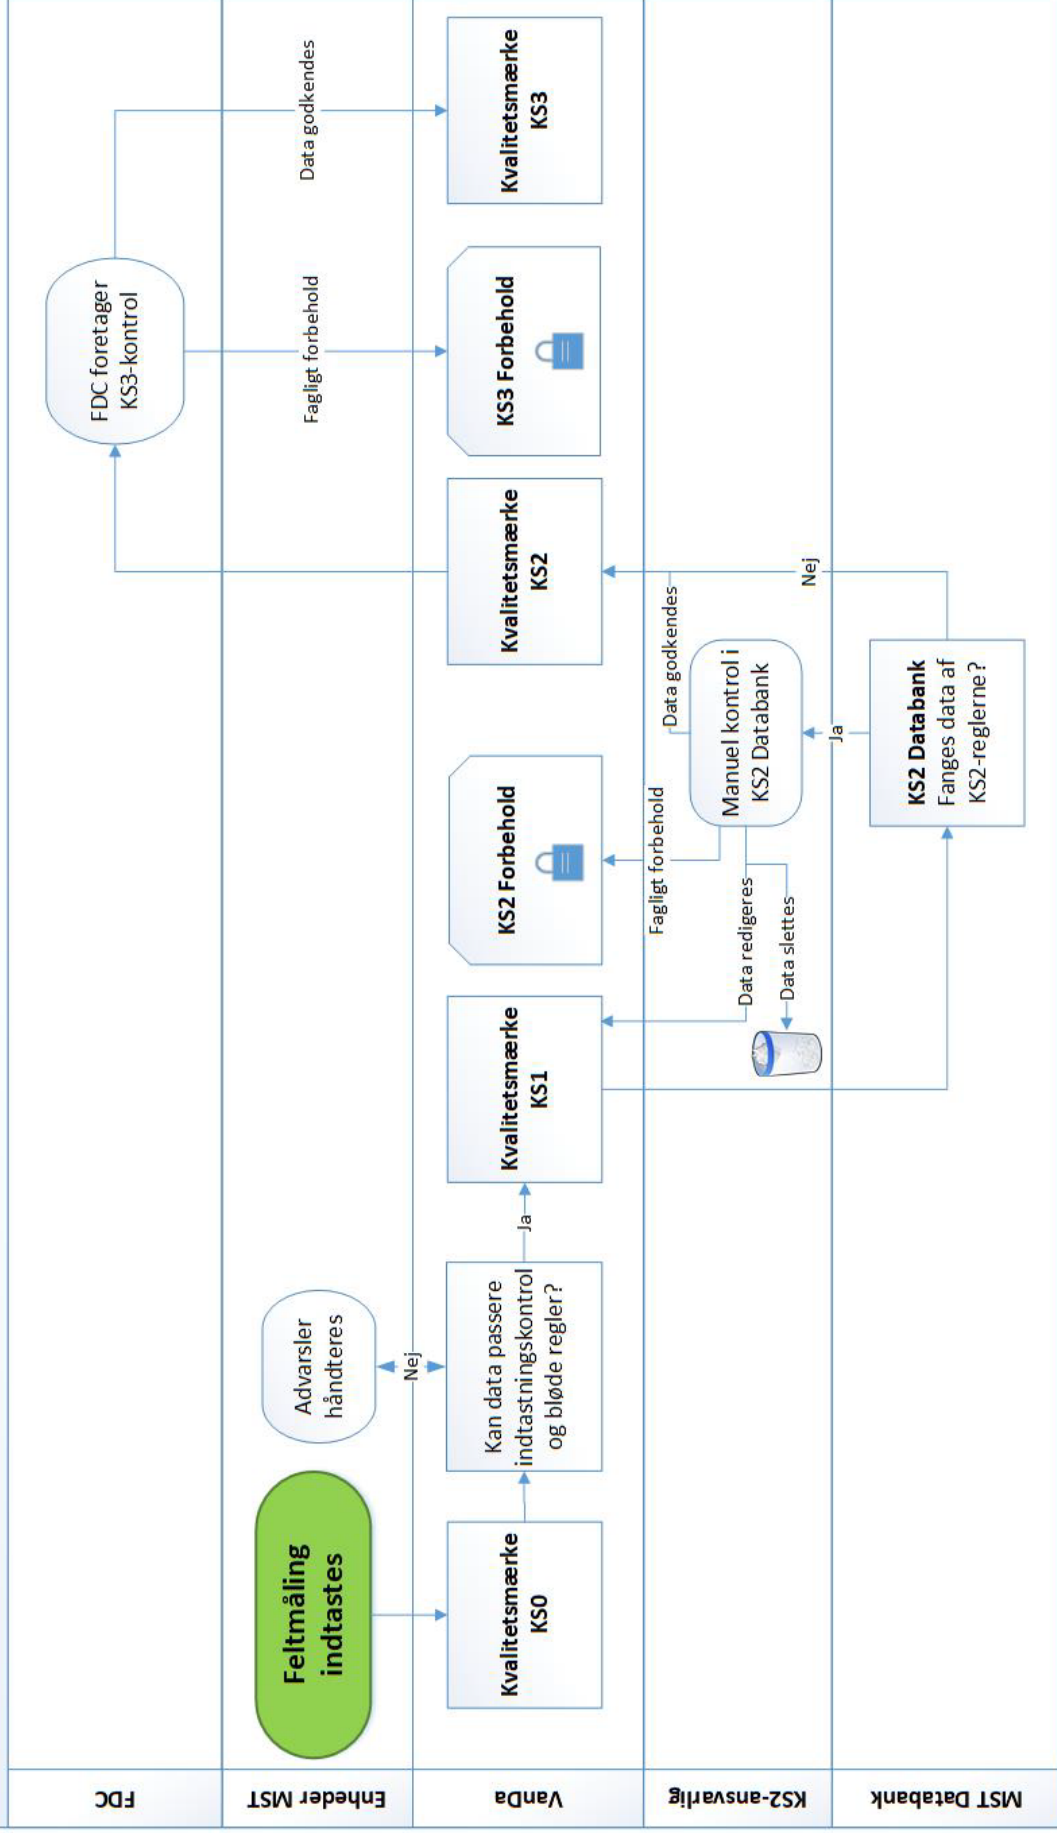

Kvalitetssikringsflow - Undersøgelser med WinArop

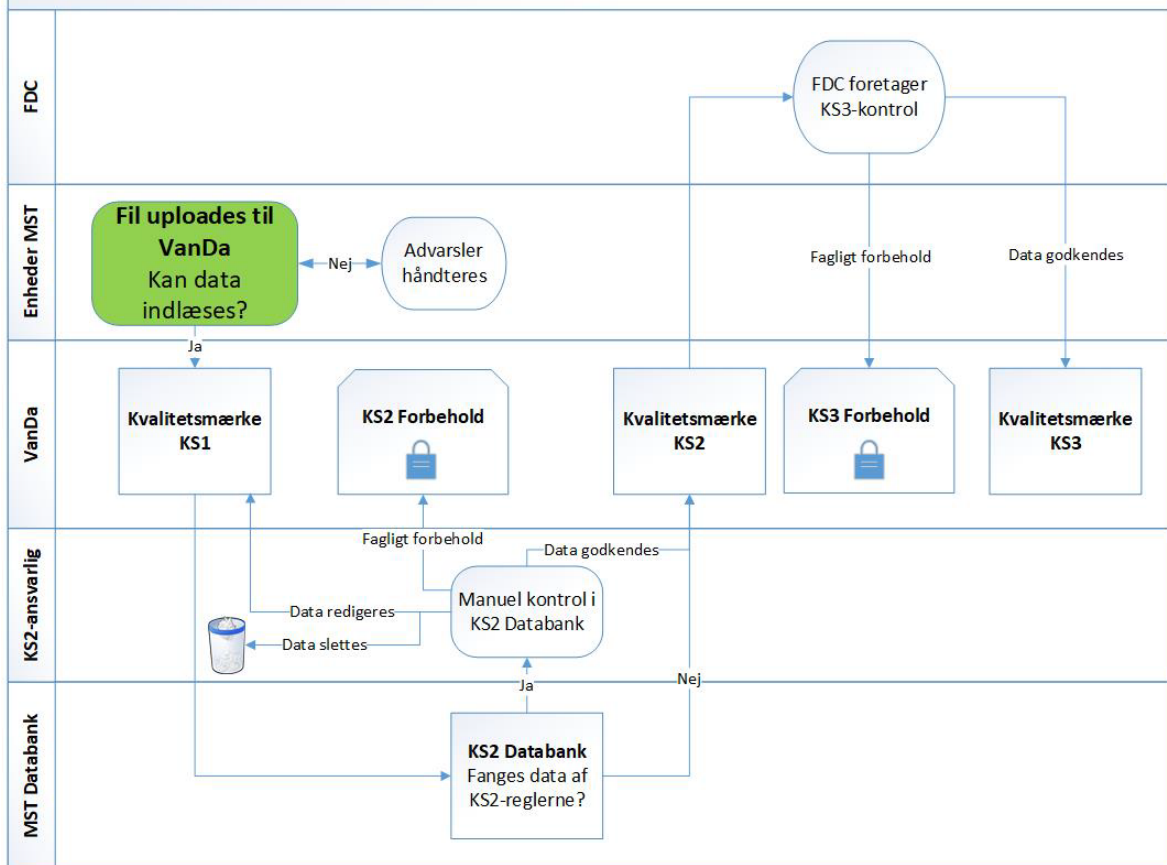

Bilag 4. Oversigt over versionsændringer

Version og faglig ansvarlig	Dato	Emne	Ændring
1.0 Miljøstyrelsen	01.09.2023	Hele dTA'en	dTA'en er tilpasset ny skabelon i forlængelse af vedtagelsen af fælles overordnede principper for kvalitetssikring af NOVANA-data samt hjemtagning af dTA'erne fra Fagdatacenter til Miljøstyrelsen